




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SIENDO LAS 09:00 AM DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2023, EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, MTRA. CECILIA LUNA GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA Y EL DR. LÁZARO RICARDO ROMERO OLVERA, RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-13-2023 PARA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023". CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12 "JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA" Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS MORALES QUE PRESENTARON ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DE COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

| NO. | NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FORMA DE PRESENTACIÓN | NUMERO DE PREGUNTAS |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 11 |
| 2 | ATK MEDICAL, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 2 |
| 3 | ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 14 |
| 4 | HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 15 |
| 5 | HOSPIMEDICAL, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 1 |
| 6 | MOBIUS MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 14 |
| 7 | TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 12 |

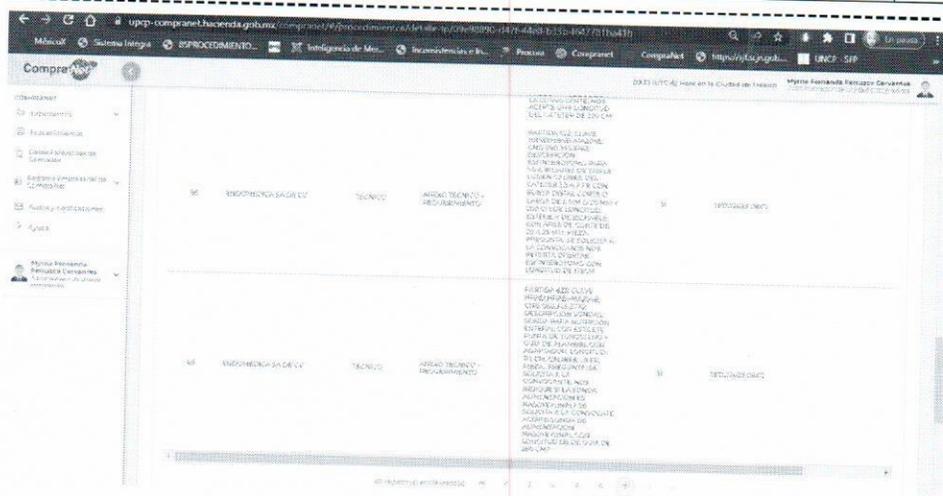



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, INFORMA QUE FUE ASISTIDO POR LA MTRA. CECILIA LUNA GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA Y EL DR. LÁZARO RICARDO ROMERO OLVERA, RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA, QUIEN SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA ACLARACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS.

ACLARACIÓN 1. ANEXO TÉCNICO. EQUIPOS. SE PRECISA QUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL USO DE LOS INSUMOS QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| Renglón | Equipo | Cantidad |
|--|---|----------|
| 441,442,443,384 y 385 | Sistema de Ecografía. (SITE RITE 8) | 1 |
| 274, 276, 405 | Lámpara externa para visualizar el sistema Vasculat Superficial (Visualizador de venas) | 2 |
| 410, 454 | Esterilizador de plasma de Gas de Peróxido de Hidrógeno. | 2 |
| 638, 398 | Equipo de desinfección de alto nivel para endoscopios flexible. | 2 |
| 411, 412, 413, 414, 415 | Equipo de sistema de control de temperatura (Artis Sun) | 5 |
| 416 | Sistema de Monitoreo de Glucosa y Cetonas en Sangre | 70 |
| 243, 244, 245, 246, 247, 248, 288, 510 | Bomba de infusión para el suministro de líquidos y fármacos por vía parenteral, enteral o epidural. | 438 |
| 382, 383, 384,403,404 | Sistema de Ecografía. (SITE RITE 5) | 1 |
| 506,507,508,509 | Perfusores. | 10 |
| 720,722,723,729 | Sistema para facoemulsificación sin láser | 1 |
| 728, 729 | Sistema para facoemulsificación con láser | 1 |
| 462 | Calentadores de sábanas. | 5 |
| 399 | Pistola Magnum | 2 |
| 377,378 | Monitores Hemodinámico (EDWARDS Hemosphere) | 2 |
| no aplica | Lente Resight 500 para microscopio Opmi-Lumera. | 1 |
| 726 | Lámpara de luz ultravioleta | 1 |
| 292, 293, 324, 325, 427-436, 458-460 | Equipo de presión negativa (Sistema V.A.C) | 17 |





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

1.- AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.-----

PREGUNTA 1. PARTIDA: 144 CLAVE: HRAEI-MA0607 CNS: 060.168.1455 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 3.0 MM. CALIBRE: 12 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 3.0 MM. CALIBRE: 12 FR. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 2. PARTIDA: 145 CLAVE: HRAEI-MA0608 CNS: 060.168.5340 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 3.5 MM. CALIBRE: 14 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 3.5 MM. CALIBRE: 14 FR. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 3. PARTIDA: 149 CLAVE: HRAEI-MA0612 CNS: 060.168.5407 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 4. PARTIDA 142 CLAVE: HRAEI-MA0605 CNS: 060.167.8220 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.0 MM. CALIBRE: 8 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.0 MM. CALIBRE: 8 FR. PIEZA ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 5. PARTIDA: 143 CALVE: HRAEI-MA0606 CNS: 060.167.8238 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.5 MM. CALIBRE: 10 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.5 MM. CALIBRE: 10 FR. ¿SE ACEPTA?-----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 6. PARTIDA: 146 CLAVE: HRAEI-MA0609 CNS: 060.168.5365 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 4.0 MM. CALIBRE: 16 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 4.0 MM. CALIBRE: 16 FR. ¿SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 7. PARTIDA: 147 CLAVE: HRAEI-MA0610 CNS: 060.168.5381 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 4.5 MM. CALIBRE: 18 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 4.5 MM. CALIBRE: 18 FR. ¿SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 8. PARTIDA: 148 CLAVE: HRAEI-MA0611 CNS: 060.168.5399 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. ¿SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 9. PARTIDA: 150 CLAVE: HRAEI-MA0613 CNS: 060.168.5431 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. ¿SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 10. PARTIDA: 151 CLAVE: HRAEI-MA0614 CNS: 060.168.5456 CUCOP: 25400519 DESCRIPCIÓN: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES: TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO, ELABORADA EN PVC GRADO MÉDICO, TERMOSENSIBLE, RESISTENTE A LA TORSIÓN, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. ¿SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 11. II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN II.2 DETERMINACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PARTIDAS: POR PARTIDA ÚNICA A UN SOLO PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO Y II.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN A UN SOLO LICITANTE. LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SÓLO LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR POR RENGLÓN ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LA PARTIDA ÚNICA SE INTEGRA DEL REGLÓN 1 AL 739, POR LO QUE SU PROPUESTA DEBE CONTENER EL 100% DE LOS RENGLONES. -----

2.- ATK MEDICAL, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. PARTIDA 74: GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLE. TAMAÑOS: CHICOS. ENCASE CON 100 PIEZAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN PRESENTACIÓN DE ENVASE CON 200 PIEZAS, AJUSTANDO LA CANTIDAD REQUERIDA A LA PRESENTACIÓN SUGERIDA." -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 2. PARTIDA 470: CUBRE BOCAS N-95 3M MOD. 90101 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA DE PRODUCTO A LA SOLICITADA, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES. ESTO PARA FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA CON MARCAS NACIONALES, CALIDAD Y COSTOS." -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

3.- ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. PARTIDA 108 CLAVE HRAEI; HRAEI-MA0500; CNIS 060.830.7179 DESCRIPCIÓN PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FRX10 FR. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA MEDIDA? DICE: PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FRX10 FR DICE: ¿PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FRX10 CM LONGITUD DEL STEND?-----

RESPUESTA: SE ACLARA QUE LA DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN 108 ES:-----

| | | | | |
|-----|--------------|--------------|----------|---|
| 108 | HRAEI-MA0500 | 060.830.7179 | 25400460 | SONDAS. SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON ESTILETE PUNTA DE TUNGSTENO Y GUÍA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD: 114 CM. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. |
|-----|--------------|--------------|----------|---|

PREGUNTA 2. PARTIDA 196; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA2327; CNIS 060.345.3671; DESCRIPCIÓN EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRES 3, 4, 5, 6, 8, 10 Y 12 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA MITTY POLLACK CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD CON ESTILETE FLEXIBLE O DOS AGUJAS TIPO SHIBA CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON ESTILETES FLEXIBLES. UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 7 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD. EQUIPO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRES 3, 4, 5, 6, 8, 10 Y 12 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA MITTY POLLACK CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD CON ESTILETE FLEXIBLE O DOS AGUJAS TIPO SHIBA CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON ESTILETES FLEXIBLES. UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 8.5FR X 25CMS DE LONGITUD. EQUIPO. MARCA COOK ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 3. PARTIDA 541; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA4386; CNIS SIN CLAVE; DESCRIPCIÓN PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) CON RECUBRIMIENTO LIBERADOR DE EVEROLIMUS O PACLITAXEL, ESTRUCTURA DE PLATINO - CROMO BALON DE ALTA PRESIÓN Y BAJO PERFIL. DAMETRO: 2.25 A 5.00 MM, LONGITUD 8 A 38 MM. PIEZA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS CORONARIA DE CROMO-COBALTO Y ES LIBERADOR DE SIROLIMUS MARCA TRANSLUMINA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 4. PARTIDA 561; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA7269; CNIS SIN CLAVE; DESCRIPCIÓN BALÓN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA DE ULTRABAJO PERFIL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. DIÁMETRO DEL BALÓN 1.2 MM, LONGITUD DE 9 A 15 MM. PIEZA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON DIAMETRO DE 1.5 MM Y UNA LONGITUD DE 15 MM. MARCA TRANSLUMINA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 5. PARTIDA 597 CLAVE HRAEI; HRAEI-MA8309; CNIS SIN CLAVE. DESCRIPCIÓN INTRODUCTORE PARA CATÉTERISMO FEMORAL DESECHABLE. LONGITUD: 11 CM. CALIBRE: DE 5 A 8 FR. INCLUYE MINI GUÍA DE 45 CM. CALIBRE 0.35 (CAMISA Y DILATADOR). PIEZA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORE PARA CATÉTERISMO FEMORAL DESECHABLE. LONGITUD: 13 CM. CALIBRE: 8 FR. (CON CAMISA Y DILATADOR). PIEZA. MARCA COOK ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 6. PARTIDA 602; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA8373; CNIS SIN CLAVE; DESCRIPCIÓN STENT AUTOEXPANDIBLE NITINOL SUPERA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR STENT AUTOEXPANDIBLE NITINOL SILVER FLEX, MARCA COOK ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 7. PARTIDA 615; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA1375; CNIS 060.165.0013; DESCRIPCIÓN PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FR X 7 FR. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA MEDIDA? DICE: PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FRX7 FR DICE: PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FRX7 CM LONGITUD DEL STEND? -----

RESPUESTA: SE ACLARA QUE LA DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN 615 ES:

| | | | | |
|-----|--------------|--------------|----------|--|
| 615 | HRAEI-MA1375 | 060.165.0013 | 25400100 | CATÉTERES. CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES CON DOBLE LUMEN CALIBRE 5.0 A 6.8 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.0 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. BALÓN: 8.5 A 12 ML. PIEZA. LAS MEDIDAS DEL CATÉTER SERÁN SELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. |
|-----|--------------|--------------|----------|--|





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 8. PARTIDA 617; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA1465; CNIS 060.345.3218; DESCRIPCIÓN CANASTILLA DE DORMIA DE MULTIFILAMENTO PARA EXTRACCION DE CALCULOS EN LA VIA BILIAR, CALIBRE 7 FR., LONGITUD 200 CM., DIMENSION DE LA CANASTILLA 1.5 X 3.5 CM. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. PIEZA. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LONGITUD DE LA VAINA DE 220 CM? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 9. PARTIDA 618; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA1471; CNIS 060.345.3309; DESCRIPCIÓN CANASTILLA DE DORMIA DE MULTIFILAMENTO PARA EXTRACCION DE CALCULOS EN LA VIA BILIAR, CON PUNTA FILIFORME, CALIBRE 7 FR., LONGITUD 240 CM., DIMENSION DE LA CANASTILLA 1.5 X 3.5 CM. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. PIEZA. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LONGITUD DE LA VAINA DE 220 CM? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 10. PARTIDA 619; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA1475; CNIS 060.346.0015; DESCRIPCIÓN PINZAS PARA BIOPSIAS GASTROSCOPIO 2.2 MM 240 CM. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA LONGITUD SEA DE 230 CM?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 11. PARTIDA 620; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA1477; CNIS 060.346.0031; DESCRIPCIÓN CLIP ENDOSCOPICO LARGO 235 CM CANAL DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 2.8 MM. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA LONGITUD SEA DE 230 CM?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 12. PARTIDA 621; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA1481; CNIS 060.463.1820; DESCRIPCIÓN AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA, CALIBRE 4, LONGITUD 240 CM. AGUJA 23 G. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. PIEZA. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE UNA LONGITUD DEL CATETER DE 220 CM. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 13. PARTIDA 622; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA2045; CNIS 060.345.3762; DESCRIPCIÓN ESFINTERÓTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN CALIBRE DEL CATÉTER 5.5 A 7 FR CON PUNTA DISTAL CORTA O LARGA DE 5 MM O 20 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ÁREA DE CORTE DE: 20 A 25 MM. PIEZA. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO CON LONGITUD DE 175 CM. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 14. PARTIDA 623; CLAVE HRAEI; HRAEI-MA2046; CNIS 060.345.3770; DESCRIPCIÓN SONDAS. SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON ESTILETE PUNTA DE TUNGSTENO Y GUÍA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD: 114 CM. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI LA SONDA ALIMENTACIÓN ES NASOYEYUNAL? ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL CON LONGITUD DE DE GUIA DE 260 CM? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

4.- HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.-----

PREGUNTA 1. FORMATO 10 DECLARACION DE NORMAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA MODIFICAR DICHO FORMATO PARA QUE MANIFIESTE LAS NORMAS CON LAS QUE CUMPLEN LOS PRODUCTOS OFERTADOS. SIN QUE SEA MOTIVO PARA DESECHAR NUESTRA PROPUESTA. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 2. PARTIDA 47 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON INTERFASE DE HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICÓN, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. MEDIDAS 20 CM X 17 CM. CAJA CON 5 PIEZAS. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 3. PARTIDA 124 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR VENDA EXTENSIBLE DE GASA BLANCA IMPREGNADA CON UNA PASTA BLANDA DE ÓXIDO DE ZINC NO SOLIDIFICABLE ACACIA, GLICERINA, ACEITE DE RECINO, VASELINA Y AGUA, ELABORADA DE FIBRAS DE POLIESTER Y ALGODÓN. PROPORCIONA ELASTOCOMPRESIÓN. MEDIDAS DE 7.5 CM X 10 M. CAJA CON 1 PIEZA. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 4. PARTIDA 241 TAPETE SANITARIO PARA ÁREA LIMPIA CON 30 HOJAS DE 0.457 X 0.914 CM CAJA CON 4 TAPETES. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NO PERMITA COTIZAR UN TAPETE SANITARIO PARA ÁREA LIMPIA CON 30 HOJAS DE 45.7CM X 116.8 CM CAJA CON 4 TAPETES. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 5. PARTIDA 252 SE HACE LA RESPETUOSA ACLARACIÓN A LA CONVOCANTE QUE EXISTEN DOS TIPOS DE CINTA TESTIGO, VERDE PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR Y ROJA PARA ESTERILIZACIÓN FORMALDEHIDO. SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS INDIQUE EL COLOR DE LA CINTA TESTIGO QUE REQUIERE. -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE SE REQUIERE PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR (VERDE). -----

PREGUNTA 6. PARTIDA 252 CINTA TESTIGO CAJA CON 28 PIEZAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO SE ME PERMITA ENTREGAR EL EQUIVALENTE EN MI PRESENTACIÓN DE CAJA CON 48 PIEZAS. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 7. PARTIDA 285 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITO HIDROCELULAR NO ADHESIVO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LAS SECRECIONES QUE SE PRODUCEN EN LAS TRAQUEOTOMÍAS. MEDIDA 10 X 10 CM. CAJA CON 10 PIEZAS. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 8. PARTIDA 292 SOLICITAN ESPONJA DE PLATA PEQUEÑA. PIEZA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI SE REFIERE AL APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO CON PLATA IÓNICA, HIDROFÓBICO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

CONTIENE 1 ESPONJA DE 10 CM X 7.5 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR TRAC Y PELÍCULA ADHESIVA. PRESENTACIÓN KIT. -----

RESPUESTA: SI, SE REFIERE A LA PRESENTACIÓN KIT DEL APÓSITO.-----

PREGUNTA 9. PARTIDA 293 SOLICITAN CANISTER. PIEZA, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA COTIZAR RECOLECTOR DE FLUIDOS GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML. CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS QUE CONTIENE LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, CON COPLEE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN COMPATIBLE CON EQUIPO DE PRESIÓN NEGATIVA CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA UN MEJOR CONTROL Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EL PROFESIONAL DE LA SALUD-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 10. PARTIDA 324 SOLICITAN ESPONJA DE PLATA GRANDE PIEZA, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI SE REFIERE AL APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA GRANDE, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO CON PLATA IÓNICA, HIDROFÓBICO. CONTIENE 1 ESPONJA DE 25.6 CM X 15 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR TRAC Y PELÍCULA ADHESIVA. PRESENTACIÓN KIT. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO QUE SE REFIERE AL ÁPOSITO. -----

PREGUNTA 11. PARTIDA 325 SOLICITAN ESPONJA DE PLATA MEDIANA. PIEZA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI SE REFIERE AL APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO CON PLATA IÓNICA, HIDROFÓBICO. CONTIENE 1 ESPONJA DE 18 CM X 12.5 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR TRAC Y PELÍCULA ADHESIVA. PRESENTACIÓN KIT.-----

RESPUESTA: ES CORRECTO QUE SE REFIERE AL ÁPOSITO. -----


PREGUNTA 12. PARTIDA 337 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. FIBRAS ESTÉRIL 2 GRS. CAJA CON 5 PIEZAS.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 13. PARTIDA 353 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE OFERTAR EN DICHA CLAVE EL PRODUCTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 20 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE."-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 14. PÁGINA 94 ANEXO TÉCNICO LA CONVOCANTE DESCRIBE LO SIGUIENTE: LOS LICITANTES, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN OFERTAR SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN DESCRITOS DEL

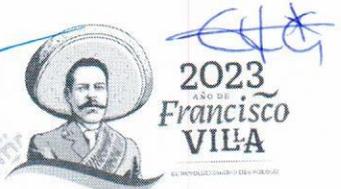



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

NUMERAL 1 AL 6."-----

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ALCARACIÓN REALIZADA POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 15. PARTIDAS 1 A LA 739 EXISTEN ALGUNOS INSUMOS QUE SOLO PUEDEN SER UTILIZADOS CON EQUIPO Y QUE NO ESTÁN DESCRITOS EN LOS NUMERALES DEL 1 AL 6 CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, POR FAVOR NOS INDIQUE SÍ EL HOSPITAL CUENTA CON ESTOS EQUIPOS COMO BIENES PATRIMONIALES O SI EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIRLOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, SI ASÍ FUESE, AGRADECERÉ ¿NOS INDIQUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y LA CANTIDAD QUE SE REQUIEREN?-----

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ALCARACIÓN REALIZADA POR LA CONVOCANTE. -----

5.- HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. PARTIDA 446 HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE. MATRIZ DE GELATINA DE COLÁGENO (DERIVADO BOVINO) UN COMPONENTE DE TROMBINA HUMANA 500 UI/ML UN DILUYENTE Y ACCESORIOS PARA SU RECONSTITUCIÓN. PRESENTACIÓN DE 5 ML. PREGUNTA: SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MATRIZ HEMOSTÁTICA BIOABSORBIBLE, CON ESFERAS DE GELATINA DE COLAGENO (DERIVADO BOVINO), TROMBINA HUMANA 2500 UI (500 UI/ML) 5ML. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

6.- MOBIUS MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.-----

PREGUNTA 1. PARTIDA 310 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HEMOSTÁTICO 100% COLÁGENO DE BOVINO, FLEXIBLE, SE PUEDE CORTAR A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS, MEDIDAS 8.0 CM X 12.5 CM X 3 MM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 2. PARTIDA 311 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HOJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS 7.0 CM X 3.5 CM. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 3. PARTIDA 312 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, HOJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS 7.0 CM X 7.0 CM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 4. PARTIDA 313 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HEMOSTÁTICO 100% COLÁGENO DE BOVINO, FLEXIBLE, SE PUEDE CORTAR A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

ANASTOMOSIS, MEDIDAS 8.0 CM X 12.5 CM X 3 MM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 5. PARTIDA 314 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HEMOSTÁTICO 100% COLÁGENO DE BOVINO, FLEXIBLE, SE PUEDE CORTAR A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS, MEDIDAS 8.0 CM X 12.5 CM X 1 CM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 6. PARTIDA 315 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HEMOSTÁTICO 100% COLÁGENO DE BOVINO, FLEXIBLE, SE PUEDE CORTAR A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS, MEDIDAS 2 CM X 6.25 CM X 7 MM. ¿ SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 7. PARTIDA 317 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HEMOSTÁTICO 100% COLÁGENO DE BOVINO, FLEXIBLE, SE PUEDE CORTAR A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS, MEDIDAS 8 CM X 6.25 CM X 1 CM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 8. PARTIDA 318 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR HEMOSTÁTICO EN POLVO DE ALMIDÓN 100% VEGETAL CON TECNOLOGÍA DE MICROESFERAS DE POLISACÁRIDOS MICROPOROSOS, DE 1GRS CON COBERTURA DE 25 CM2, EL CUAL NO REQUIERE REFRIGERACIÓN, NI PREPARACIÓN, LISTO PARA USARSE Y EL CUAL SE ABSORBE DE 24 A 48 HRS. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 9. PARTIDA 356 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HOJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS 7.0 CM X 7.0 CM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 10. PARTIDA 357 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HEMOSTÁTICO 100% COLÁGENO DE BOVINO, FLEXIBLE, PARA PROCEDIMIENTOS ABIERTOS Y MÍNIMAMENTE INVASIVOS, SE PUEDE CORTAR A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS, MEDIDAS 8.0 CM X 12.5 CM X 3 MM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 11. PARTIDA 358 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN MATERIAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LO PUBLICADO EN BASES, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HEMOSTÁTICO 100% COLÁGENO DE BOVINO, FLEXIBLE, SE PUEDE CORTAR A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO, IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES PLANAS O PARA ENVOLVER VASOS Y SITIOS DE ANASTOMOSIS, MEDIDAS 8 CM X 6.25 CM X 1 CM. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 12. PARTIDA 359 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: HEMOSTÁTICO DE ALMIDÓN 100% VEGETAL CON TECNOLOGÍA DE MICROESFERAS DE POLISACÁRIDOS MICROPOROSOS, DE 5 GRS CON COBERTURA DE 125.90 CM2, EL CUAL NO REQUIERE REFRIGERACIÓN, NI PREPARACIÓN, LISTO PARA USARSE Y EL CUAL SE ABSORBE DE 24 A 48 HRS. CON ADAPTADOR FLEXITIP DE 38 CMS DE LONGITUD PARA USO EN LAPAROSCOPIA Y EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 13. PARTIDA 446 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR HEMOSTÁTICO DE ALMIDÓN 100% VEGETAL CON TECNOLOGÍA DE MICROESFERAS DE POLISACÁRIDOS MICROPOROSOS, DE 5 GRS CON COBERTURA DE 125.90 CM2, EL CUAL NO REQUIERE REFRIGERACIÓN, NI PREPARACIÓN, LISTO PARA USARSE Y EL CUAL SE ABSORBE DE 24 A 48 HRS. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 14. PARTIDA 488 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR HEMOSTÁTICO EN POLVO DE ALMIDÓN 100% VEGETAL CON TECNOLOGÍA DE MICROESFERAS DE POLISACÁRIDOS MICROPOROSOS, DE 3GRS CON COBERTURA DE 82.88 CM2, EL CUAL NO REQUIERE REFRIGERACIÓN, NI PREPARACIÓN, LISTO PARA USARSE Y EL CUAL SE ABSORBE DE 24 A 48 HRS. ¿SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

7.- TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 6 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN CUBETA DE 4 LITROS -----


RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA POR PIEZA ES EN GARRAFAS DE 5 LITROS. NO OBSTANTE, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN EN CASO DE CONTAR CON UNA PRESENTACIÓN DISTINTA DEBERÁN REALIZAR EL AJUSTE DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 2. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 21 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA MASCARILLA CON DOBLE SELLO -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 3. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 22 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA MASCARILLA CON DOBLE SELLO -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

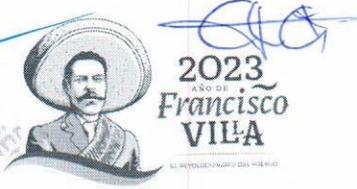



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 4. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 290 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE DEBERÁN CONSIDERAR EL RANGO QUE REFIEREN LOS MANUALES.-----

PREGUNTA 5. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 290 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) -----

RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN AMBOS ADITAMENTOS (MANOMETRO Y VALVULA PEEP).-----

PREGUNTA 6. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 290 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE REANIMADOR REUSABLE O DESECHABLE -----

RESPUESTA: DESECHABLE.-----

PREGUNTA 7. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 291 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) -----

RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN AMBOS ADITAMENTOS (MANOMETRO Y VALVULA PEEP).-----

PREGUNTA 8. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 291 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE REANIMADOR REUSABLE O DESECHABLE -----

RESPUESTA: DESECHABLE.-----

PREGUNTA 9. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 294 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) -----

RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN AMBOS ADITAMENTOS (MANOMETRO Y VALVULA PEEP).-----

PREGUNTA 10. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 294 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE REANIMADOR REUSABLE O DESECHABLE -----

RESPUESTA: SE REQUIERE REANIMADOR DESECHABLE.-----

PREGUNTA 11. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 476 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE RESUCITADOR REUSABLE? -----

RESPUESTA: DEBERÁ SER DESECHABLE.-----

PREGUNTA 12. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE MASCARILLA REUSABLE O DESECHABLE. -----

RESPUESTA: DEBERÁ SER DESECHABLE -----

UNA VEZ DADAS LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESUS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARAN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE SE





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

DIO RESPUESTA PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE SEIS HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN EL SISTEMA COMPRANET. ASIMISMO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARAN LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE DOS HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ESTAS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, VERIFICAR SU CONTENIDO EN EL SISTEMA COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx> SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE ACTO.

ESTA ACTA, CONSTA DE CATORCE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 09:35 AM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LA CONVOCANTE:

| NOMBRE | CARGO Y/O ÁREA | FIRMA |
|--|---|-------|
| LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | |
| LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES | RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES | |
| MTRA. CECILIA LUNA GARCÍA | RESPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA | |
| DR. LÁZARO RICARDO ROMERO OLVERA | RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS | |

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

FIN DEL ACTA

